(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-340752 (P2003-340752A)

(43)公開日 平成15年12月2日(2003.12.2)

(51) Int.CL.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

B 2 5 J 3/00

A 6 1 B 19/00

502

B 2 5 J 3/00

Z 3C007

A 6 1 B 19/00

502

審査請求 有

請求項の数8

OL (全12頁)

(21)出願番号

特面2002-145798(P2002-145798)

(22)出題日

平成14年5月21日(2002.5.21)

(出願人による申告) 国などの委託研究の成果に係る特 許出願(平成13年度新エネルギー・産業技術総合開発機 構「医療福祉機器技術研究開発」委託研究、産業活力再 生特別指置法第30条の適用を受けるもの) (71)出願人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(71)出旗人 899000079

学校法人康應義發

東京都港区三田2丁目15番45号

(72)発明者 砂 押 貴 光

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝研究関発センター内

(74)代理人 100075812

弁理士 吉武 賢次 (外5名)

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 医療用マニピュレータ

(57)【要約】

【課題】 術者の負担を軽減させる操作性の良いマスタスレーブ方式で動作する医療用マニピュレータを提供する。

【解決手段】 マスタスレーブ方式で動作する医療用マニピュレータであって、複数の自由度で作業を行うスレーブ部(3)と、スレーブ部を操作指令するマスタ部(2)と、スレーブ部の複数の自由度の中の特定した特定自由度の動作に対し所定拘束条件に従って拘束及びその解除を指令する拘束指令部(22)と、拘束指令部の指令によって特定自由度の拘束が開始されてから拘束が解除されるまでの間にマスタ部の姿勢とスレーブ部の姿勢との間に生じる姿勢差を検出する姿勢差検出手段

(6)と、姿勢差検出手段で検出した姿勢差に基づき、マスタ部の姿勢とスレーブ部の姿勢とが所定の姿勢関係を有するようにスレーブ部の姿勢を調整する姿勢調整部(8)と、を備えることを特徴とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】マスタスレーブ方式で動作する医療用マニ ピュレータであって、

複数の自由度で作業を行うスレーブ部と、

前記スレーブ部を操作指令するマスタ部と、

前記スレーブ部の前記複数の自由度の中の特定した特定 自由度の動作に対し所定拘束条件に従って拘束及びその 解除を指令する拘束・解除司令部と、

前記拘束・解除司令部の指令によって前記特定自由度の 拘束が開始されてから拘束が解除されるまでの間に前記 10 マスタ部の姿勢と前記スレーブ部の姿勢との間に生じる 姿勢差を検出する姿勢差検出手段と、

前記姿勢差検出手段で検出した姿勢差に基づき、前記マスタ部の姿勢と前記スレーブ部の姿勢とが所定の姿勢関係を有するように前記スレーブ部の姿勢を調整する姿勢調整部と、を備えることを特徴とする医療用マニピュレータ。

【請求項2】前記マスタ部と前記スレーブ部とを一体的 に接続する連結部を有し、一体型の医療用マニピュレー タであることを特徴とする請求項1に記載の医療用マニ 20 ピュレータ。

【請求項3】前記拘束・解除司令部の指令に基づいて前記特定自由度が拘束されている時間に渡って、前記特定自由度に対応する前記マスタ部の自由度の動作は推続することを特徴とする請求項1または2に記載の医療用マニピュレータ。

【請求項4】前記所定拘束条件は、部分的に動作を可能 にする非完全拘束条件であることを特徴とする請求項1 乃至3のいずれかに記載の医療用マニピュレータ。

【請求項5】前記特定自由度と前記所定拘束条件を表示 30 する拘束状態表示部を備えることを特徴とする請求項1 乃至4のいずれかに記載の医療用マニピュレータ。

【請求項6】前記拘束・解除司令部は、複数の前記特定自由度の指令を可能であり、特定する複数の前記特定自由度を段階的または同時に指令可能であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の医療用マニビュレータ。

【請求項7】前記特定自由度の拘束開始から拘束解除ま マニ での手順を術者に教示する教示手段を備えることを特徴 レー とする請求項1乃至6のいずれかに記載の医療用マニピ 40 る。 ュレータ。 【0

【請求項8】前記拘束・解除司令部は、まず拘束する前記特定自由度を選択し、その後に選択された前記特定自由度の拘束と解除を指定可能であることを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の医療用マニピュレータ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、医療用マニピュレータに係り、特にマスタ部とスレーブ部とを有しマスタ 50

スレーブ方式で動作する医療用マニピュレータに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、胆のう摘出手術などの腹腔鏡下手術においては、患者の腹部に小さな穴をあけ、その部分にトラカールを取り付け、トラカールを介して内視鏡や鉗子を挿入し、術者が内視鏡の映像をモニタで見ながら手術を行っている。このような手術方法は開腹を必要としないため患者への負担が少なく術後の回復や退院までの日数が大幅に低減される。このように腹腔鏡下手術は患者への負担が少ないという点で優れ適用分野の拡大が期待されるものである。しかしその反面、術者にとっては直接患部が見られない、開閉グリッパしか設けられていない操作性に乏しい鉗子を使用し、必ずしも手術に適したものとはいえず、術者の熟練した技術を要するものであった。

【0003】そこで鉗子先端に姿勢の自由度を与え、複数の自由度を持つ操作部(マスタ部)を術者が操作し、複数の自由度を持つ先端の作業部(スレーブ部)が操作部の動きに合わせて動作するマスタスレーブ方式によって腹腔鏡下手術を行うことが研究され導入されつつある。

【0004】マスタスレーブ方式の医療用マニピュレータのひとつとして、マスタ部とスレーブ部とが離れたところに位置する遠隔操作型がある。スレーブアームを患者の側に複数配し、患者から離れた所にあるマスタ部を操作し、医療用マニピュレータ先端の位置と姿勢を制御するものである。このシステムは複雑で大掛かりなものとなりコストやメンテナンス性が必ずしもよくない。また患者の側に術者が直接近づいて手術を行うことができず、緊急時の対処ができないため安全性に対し問題がある。

【0005】もうひとつ、マスタスレーブ方式の医療用マニピュレータ構造として、マスタ部とスレーブ部が一部の共通軸を持ち簡素なシステムで導入しやすい一体型の医療用マスタスレーブマニピュレータがある。先に挙げた遠隔操作型のマニピュレータに対して、この一体型マニピュレータは侑者が患者の側に立ち、直接マニピュレータを操作するので、安全性の問題が大幅に軽減する

【0006】これらマスタスレーブ方式の医療用マニピュレータは、従来の鉗子が操作性の劣る原因が鉗子の先端部に自由度が少ないことにあると判断し開発されてきたものである。自由度が増えたことで従来では不可能であった方向からも作業を行うことが可能となった。しかしながら、自由度が多くなったとしてもこれらの自由度を適切に操作制御できない場合も生じ、必ずしも操作性が向上したとは言えなかった。操作性が良くないと手術の正確さや安全性に関して問題が残る。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】マスタスレーブ方式に よって医療用マニピュレータを操作するにあたり、術者 の思い通りにスレーブを操作できない場合が生じること がある。例えば、術者が意図しない動きをマニピュレー タの先端部が動作してしまう場合等であり、このような ことは、術者が作業に不必要なマスタ部の操作軸を無意 識に動作させていた場合に生じる。

【0008】通常のマスタスレーブ方式では、マスタ部 の座標系とスレーブ部の座標系との間に一定の関係が維 持されており、マスタ部の姿勢とスレーブ部の姿勢との 10 間には対応する自由度の間で常に一定の関係が一義的に 定められている。これに対し、マスタ部の位置とスレー ブ部の位置に関しては、マスタ部の位置とは独立にスレ ーブ部の位置を任意に停止したり移動したりすることが 行われ、スレーブ部の姿勢のみをマスタスレーブ方式に よって操作することで操作性を向上させることが行われ てきた。しかしながら、マスタ部とスレーブ部との位置 情報を切り離すという従来のこの方法では、マスタ部と スレーブ部が離れて位置する遠隔操作型には有効である が、一体型のマスタスレーブ方式ではマスタ部とスレー ブ部の位置関係が拘束されているため有効ではない。ま た、一体型と遠隔操作型の両者において、姿勢軸どうし の干渉に関する問題は解決されていない。

【0009】マスタ部とスレーブ部との姿勢を規定する 軸において違った動作比を与え、操作性を向上させよう とする試みがある。これは操作する手が無理な姿勢とな らないように、あらかじめマスタ部の動作比に対してス レーブ部の動作比を大きくしておくもの、また反対に、 マニピュレータに微細な動作を行わせるために、マスタ 部の動作に対しスレーブ部の動作比を小さくしておくも 30 のとがある。 前者においては動作比が大きい軸が不必要 な動作軸である場合にかえって操作性を悪化させてしま う。後者に対しては、ある範囲内の動作においては相対 的に不必要な動作軸の影響が減少するが、任意の姿勢で の作業を実現するために必要以上にマスタ部を動作させ なければならないといった問題を生じる。

【0010】また、スレーブ部に冗長軸を設けることで 隣接するマニピュレータ同士が干渉しないように制御す る方法や、スレーブ部の冗長軸を一時的に固定する方法 があるが、これはマニピュレータ全体の姿勢を制御する ものであって、先端の姿勢に対して行われるものではな

【0011】こういった問題に対し、スレーブ部の姿勢 の自由度を拘束する方法が提案されている。作業空間に 対して拘束条件を決定し、マスタスレーブ動作中に拘束 指令を与え、予め決めたその拘束条件に従ってスレーブ を動作させるものである。この方法では、作業対象とマ スタスレーブマニピュレータがある座標系に固定されて いる必要があり、その座標系をもとに拘束条件を決定し ているため、確かに、脳外科手術のように術部を完全に 50 を備えることを特徴とする。

固定する作業においては有効ではあるが、腹部のように 固定できない術部を作業対象とした場合には有効ではな い。また、一体型の医療用マニピュレータのようなスレ ーブ部とマスタ部との位置関係が固定されている器具を 使用し、その器具の動作が術部の座標系に対して任意に 変化する場合、拘束条件を術部に対して設定するのは現 実的ではない。また予め拘束条件を設定するための手続 きに時間がかかり、手術の迅速性が失われるといった問 題があった。さらには、いったん拘束条件を決めた後、 術部が動いてしまったことなどにより、拘束条件の変更

が必要な場合にも同じ問題が生じていた。

【0012】任意の方向からの作業を実現する可能性を 持ったマスタスレーブ方式の医療用マニピュレータであ っても、それを操作する術者の手の姿勢が任意の方向を とるように動作させることは人間工学的に不可能であ る。特に、一体型の医療用マニピュレータにおいては、 マスタ部のジンバル中心を空間のある位置に固定したま ま姿勢自由度を操作することは困難であり、スレーブ部 の位置に対し意図しない動きを誘発することとなる。こ の解決手段として、制御軸ごとに動作レバーやボタンを 割り当てたコントローラで操作する手段がある。この方 法では複数の軸を同時に操作することが困難であり、ま た、マスタ部とスレーブ部との姿勢関係が著しく異なる ため、直感的に操作できず操作性が悪いといった問題が 生じていた。

【0013】そこで、本発明の目的は、上記に述べた従 来技術の有する問題を解消し、マスタスレーブ方式の医 療マニピュレータの操作中に、特定したスレーブ部の特 定自由度を所定拘束条件の下に制御的に拘束とその解除 を行い、スレーブ部の操作可能な自由度数を変化させる とともに、その間にマスタ部の自由度を拘束せずにお き、マスタ部とスレーブ部との姿勢関係が一致しない状 況を一時的に作り出すことで、操作性が向上した医療用 マニピュレータを提供することである。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の医療用マニピュレータは、マスタスレーブ 方式で動作する医療用マニピュレータであって、複数の 自由度で作業を行うスレーブ部と、前記スレーブ部を操 作指令するマスタ部と、前記スレーブ部の前記複数の自 由度の中の特定した特定自由度の動作に対し所定拘束条 件に従って拘束及びその解除を指令する拘束・解除司令 部と、前記拘束・解除司令部の指令によって前記特定自 由度の拘束が開始されてから拘束が解除されるまでの間 に前記マスタ部の姿勢と前記スレーブ部の姿勢との間に 生じる姿勢差を検出する姿勢差検出手段と、前記姿勢差 検出手段で検出した姿勢差に基づき、前記マスタ部の姿 勢と前記スレーブ部の姿勢とが所定の姿勢関係を有する ように前記スレーブ部の姿勢を調整する姿勢調整部と、

30

5

【0015】また、前記マスタ部と前記スレーブ部とを 一体的に接続する連結部を有し、一体型の医療用マニピュレータであることを特徴とする。

【0016】また、前記拘束・解除司令部の指令に基づいて前記特定自由度が拘束されている時間に渡って、前記特定自由度に対応する前記マスタ部の自由度の動作は 継続することを特徴とする。

【0017】また、前記所定拘束条件は、部分的に動作を可能にする非完全拘束条件であることを特徴とする。 【0018】また、前記特定自由度と前記所定拘束条件 10を表示する拘束状態表示部を備えることを特徴とする。 【0019】また、前記拘束・解除可令部は、複数の前記特定自由度の指令を可能であり、特定する複数の前記特定自由度を段階的または同時に指令可能であることを特殊とする

【0020】また、前記特定自由度の拘束開始から拘束 解除までの手順を侑者に教示する教示手段を備えること を特徴とする。

【0021】また、前記拘束・解除司令部は、まず拘束 する前記特定自由度を選択し、その後に選択された前記 20 特定自由度の拘束と解除を指定可能であることを特徴と する。

【0022】本発明において、拘束・解除司令部によりスレーブ部の特定自由度の動作を所定拘束条件に従って拘束及びその解除を指令し、姿勢差検出手段により特定自由度の拘束が開始されてから拘束が解除されるまでの間にマスタ部の姿勢とスレーブ部の姿勢との間に生じる姿勢差を検出し、特定自由度の拘束が解除されると姿勢調整部によりマスタ部の姿勢とスレーブ部の姿勢との間に所定の姿勢関係を有するようにスレーブ部の姿勢を調整する

【0023】本発明によれば、マスタ部の意図しない動きによってスレーブ部が意図しない動作をしてしまうことを防止でき、また、特定自由度の拘束解除後にマスタ部とスレーブ部との間に生じる姿勢差を補完することを簡易に行うことができるので特者は次の作業へスムーズに移行でき、作業の迅速性を向上させ、安全性の高い医療用マニピュレータを提供することができる。

【0024】また、特定自由度が拘束されている時間に渡って、特定自由度に対応するマスタ部の自由度の動作 40を継続でき、実作業を行うスレーブ部の特定自由度に対してのみ拘束するのであって実際に手が動作させるマスタ部の対応する自由度を拘束しないことで、手技を無理なく行うことができるとともに他の軸への悪影響を無くすることができる。また、スレーブ部の特定自由度に対応するマスタ部の自由度を術者が任意の姿勢に動作させることで、手技の行いやすい姿勢にして作業を続けることができる。

【0025】また、拘束条件を部分的に動作を可能にする非完全拘束条件とすることにより、定められた所定の 50

範囲で動作することを許されるので、拘束動作中でも、 許容動作範囲でスレーブ部の姿勢を微調整することができ、術部が動いてしまうためにスレーブ部とマスタ部と の間で相対姿勢関係が多少くずれた場合においても、あるいは医療用マニピュレータをベース等に固定せずに使 用する場合においても、拘束条件を新たに修正せずとも 所望の動作を実現することができる。

[0026]

【発明の実施形態】以下に図面を参照して、本発明の医療用マニピュレータの実施の形態について説明する。ここでは、一体型の医療用マニピュレータを例にとって説明する。なお、本願発明は、一体型の医療用マニピュレータに限らず、分離型の医療用マニピュレータに対しても適用できるのはいうまでもない。

【0027】図1及び図2に示すように、マスタスレーブ方式で動作する一体型の医療用マニピュレータ1は、主に機械的動作を行うマニピュレータ本体部1aと、マニピュレータ本体部1aに対し種々の駆動制御を行う制御部1bとから構成されている。

0 【0028】マニピュレータ本体部1aには、操作者 (術者)20が操作を指令するマスタ部2と、マスタ部 2の動きにしがって複数の自由度で作業を行う作業部と して機能するスレーブ部3と、マスタ部2とスレーブ部 3とを一体的に接続する連結部4と、マスタ部2の姿勢 を検出する角度検出器11と、スレーブ部3の姿勢を検 出する角度検出器12と、スレーブ部3を駆動するモー タ13が設けられている。

【0029】制御部1bには、マニピュレータ本体部1 aを駆動制御するために種々の制御演算を行う制御演算 部21と、術者20がスレーブ部3の複数の自由度の中から特定した特定自由度の動作を所定拘束条件に従って 拘束及びその解除を指令する拘束・解除司令部22と、制御演算部21における演算結果に基づいてモータ13を駆動するためのモータ駆動回路等からなる駆動部23 とが設けられている。拘束・解除司令部22による指令はスイッチによって行うことも可能であり、その指令をフットスイッチにより行う場合には手技の妨げにならないようにできる。

【0030】また、医療用マニピュレータ1には、拘束・解除司令部22の指令によって特定自由度の拘束が開始されてから拘束が解除されるまでの間にマスタ部2の姿勢とスレーブ部3の姿勢との間に生じる姿勢差を検出する姿勢差検出手段6と、姿勢差検出手段6で検出した姿勢差に基づき、マスタ部2の姿勢とスレーブ部3の姿勢とが所定の姿勢関係を有するようにスレーブ部3の姿勢を調整する姿勢調整部8とが設けられている。ここで、マスタ部2の姿勢とスレーブ部3の姿勢とスレーブ部3の姿勢とスレーブ部3の姿勢とは予め定めた既知の関係になることをいう。

【0031】姿勢差検出手段6は、角度検出器11と角

度検出器12と制御演算部21の一部とから構成されて いる。姿勢調整部8は、制御演算部21の一部と駆動部 23とモータ13とから構成されている。

【0032】拘束・解除司令部22の指令に基づいて特 定自由度が指定されると、制御部1bはその特定自由度 に対応するスレーブ部3の動作を拘束するが、この一 方、スレーブ部3の特定自由度に対応するマスタ部2の 自由度の動作は、拘束されることなく継続される。この ため、スレーブ部3の特定自由度とこれに対応するマス 夕部2の自由度との間には、特定自由度が拘束されてい 10 る間に姿勢差が生じる。そして、拘束・解除司令部22 の指令によって特定自由度の拘束が開始されてから拘束 が解除されるまでの間にマスタ部2の姿勢とスレーブ部 3の姿勢との間には対応関係が失われる。これに対し、 次のようにして、生じた姿勢差の回復が図られる。

【0033】特定自由度の拘束が開始されてから拘束が 解除されるまでの間のマスタ部2とスレーブ部3の各々 の姿勢情報を角度検出器11と角度検出器12とによっ て検出し、検出された姿勢情報より制御演算部21にお いてマスタ部2とスレーブ部3の姿勢差を演算する。制 20 御演算部21において演算されたマスタ部2とスレーブ 部3の姿勢差の情報に基づき、拘束した期間に生じたマ スタ部2とスレーブ部3とにおける姿勢差を補完するた めに必要な駆動情報を制御演算部21において演算す る。この駆動情報に基づき、姿勢調整部8における駆動 部23及びモータ13によってスレーブ部3が、マスタ 部2とスレーブ部3との間に一定の姿勢関係が回復され るように、駆動される。

【0034】特定自由度の拘束が開始されてから拘束が 解除されるまでの間における特定自由度を拘束する拘束 30 条件は、その特定自由度に対応する動作が完全に禁止さ れるようにした完全拘束条件であってもよく、あるいは 後述するように、部分的に特定自由度の動作を可能にす る非完全拘束条件であってもよい。拘束条件を部分的に 動作を可能にする非完全拘束条件とすることにより、定 められた所定の範囲で動作することを許されるので、拘 東動作中でも、許容動作範囲でスレーブ部の姿勢を微調 整することができる。また、術部が動いてしまうために スレーブ部3とマスタ部2との間で相対姿勢関係が多少 くずれた場合においても、あるいは医療用マニヒュレー 40 タ1をベース等に固定せずに使用する場合においても、 拘束条件を新たに修正せずとも所望の動作を実現するこ とができる。

【0035】また、図2に示すように、 医療用マニピュ レータ1はどの自由度が特定自由度であるかと、その特 定自由度を拘束する拘束条件の内容を表示する拘束状態 表示部30を備えている。これによって、術者20は、 スレーブ部3の作業部のどの軸がどのように拘束されて いるかについて、確実に認識することができる。拘束状

との区別、及びそれらの拘束状態と非拘束状態との区別 を侑者20に呈示することも可能である。また、拘束状 態を腹腔鏡映像に表示させることや術者の視界にあるラ イトで知らせることで動作する自由度の認識誤りによる 誤操作を防ぐこともできる。

R

【0036】また、拘束・解除司令部22は、拘束対象 である複数の特定自由度を指定することも可能である。 この場合、特定する複数の特定自由度を段階的に加える ようにしてもよく、あるいは拘束する複数の特定自由度 を同時に指定するようにしてもよい。これによって、術 者20のより高い操作性を確保することが可能になる。 【0037】また、特定自由度の拘束開始から拘束解除 までの手順を侑者20に教示する教示手段を備えるよう にしてもよい。この教示手段による教示内容は、拘束状 態表示部30に表示するようにすればよい。

【0038】また、拘束・解除司令部22は、まず拘束 する特定自由度を選択し、その後に選択された特定自由 度の拘束と解除を指定することも可能である。この場 合、特定自由度を選択することと、選択された特定自由 度の拘束と解除の指定とが分離されているので、ある特 定自由度を選択した状態で、その拘束と解除とを頻繁に 繰り返すことができる。

【0039】スレーブ部3は術部に処置を施すための自 由度を有し、先端の姿勢が変化することができるととも に、先端に取り付けられたグリッパの開閉自由度をあわ せ持ち、それぞれ術者20の指令に応じて動作する。ス レーブ部3はワイヤやロッド、及びギヤなどで構成され る動力伝達部を介してモータ13の動力が伝わることで 動作する。

【0040】医療用マニピュレータ1がマスタスレーブ 方式で動作しているとき、通常、マスタ部2とスレーブ 部3との姿勢関係は一致している。 しかし、 グリッパの ように姿勢3軸以外に付加された軸に関しては、その軸 に係る姿勢に合わせた機構がマスタ部2に設けられてい るとは限らない。この場合、例えば、スイッチ等により グリッパの開閉動作を指令することもある。

【0041】次に、マスタスレーブ動作中にスレーブ3 の任意の軸を制御的に拘束する手続きを説明する。

【0042】術者20がマスタスレーブ方式で医療用マ ニピュレータ1を操作している最中でもスレーブ部3の 特定自由度を停止させることができる。 術者20が拘束 ・解除司令部22を操作すると、制御演算部21ヘスレ ープ部3の特定自由度の拘束の指令が伝わる。この指令 は通常、フットスイッチで行われるが、手元のスイッチ やキーボード入力、タッチパネル、音声入力等を用いた ものであっても構わない。また、拘束状態表示部30に よって、術者20にスレーブ部3の拘束制御状態を認識 させることができる。拘束状態表示部30は、拘束状態 であるか否か、どの自由度が拘束されているかといった 態表示部30によって、完全拘束状態と非完全拘束状態 50 拘束情報を、内視鏡モニタに表示したりライトを点灯し

たりすることで呈示することが可能である。制御演算部21は、拘束・解除司令部22から拘束指令が入力されるとこの入力時点におけるスレーブ部3の特定自由度の姿勢を基準とし、姿勢差検出手段6による検出結果に基づき、マスタ部2とスレーブ部3との間の姿勢差を演算する。姿勢調整部8は、拘束・解除司令部22によって拘束の解除の指令が発せられると、制御演算部21における演算結果に基づき、マスタ部2とスレーブ部3との間の姿勢差が解消されるようにスレーブ部3を駆動する

【0043】次に、拘束条件が、部分的に特定自由度の動作を可能にする非完全拘束条件である場合について、図10を参照して説明する。なお、以下に述べる非完全拘束条件の下でも、角度検出器11と角度検出器12とによって常にマスタ部2とスレーブ部3の姿勢を検出しているので、姿勢差検出手段6は完全拘束条件の下である場合と同様にマスタ部2とスレーブ部3との間の姿勢差を検出することができる。

【0044】拘束指令部22から拘束指令が入力された時点での特定自由度の姿勢角度を基準姿勢 θ B とし、拘 20 束されるスレーブ部3の特定自由度の範囲を決定する特定自由度に対応するマスタ部2の両端の姿勢角度をαおよびβとし、基準姿勢に対して

$$\alpha \le \theta_{\rm B} \le \beta$$
 式(1)

となるように定める。マスタ部の姿勢角度 θ_m に対応するスレーブ部の姿勢角度を $f(\theta_m)$ と定義すれば、スレーブ部3は式(1)に対して

$$f(\alpha) \le f(\theta_B) \le f(\beta)$$
 式(2)
と定められる。

【0045】スレーブ部3の特定自由度の基準姿勢が式 30 (2)を満たさない場合、すなわち姿勢角度 $f(\theta_B)$ が 姿勢角度 $f(\alpha)$ より小さいかあるいは姿勢角度 $f(\beta)$ よ り大きい場合には、特定自由度をその限度の姿勢角度に 完全拘束する。スレーブ部3の特定自由度の基準姿勢f (θ_B) が式 (2)を満たす場合は、決められた条件のも とで特定自由度を拘束する制御指令を生成する。ここ で、決められた条件とは、マスタ部2からの入力情報と スレーブ部3の姿勢を制御する出力情報との関係を与え るものであり、通常のマスタスレーブ動作においてはこ の入力と出力の両者の比は1対1であるのに対し、式 (1)を満たす非完全拘束領域下では両者の比を1:rとする。このアの値を1より小さくすることで、非完全 拘束領域下でのスレーブ部3の動きに制限をかけ、術者 20に対しても拘束感を出すことができる。 さらにマス 夕部2からの比較する入力信号にはフィルタ処理を施 し、手ぶれなどにより発生する高い周波数入力をカット する。また同時に、姿勢角度 θ B の変化分の大きさによ って、その変化分がある値より大きいものは意味のある 動きと解釈しカットせずに非完全拘束条件下で動作させ

に慎重になっており、ある時間に渡って大きな振れ(変化分)を続けていたらそれは意味があると解釈すべきである。ただし、振れの往復回数が少ない場合は意図しないことがあるので、その場合は入力をカットしてスレーブ部3を動作させる。非完全拘束領域を決める姿勢角度 αおよびβや値ァを予め術者20によって任意に与えることができ、また、操作中も制御部1 bに姿勢角度 αおよびβや値ァを入力することで作業状況に合わせて適宜変化させることできる。これらの値を導入することで、スレーブ部3は拘束・解除司令部22から拘束指令を発

スレープ部3は拘束・解除可令部22から拘束指令を発したの後も式(1)を満たす範囲で動作することが許可され、作業対象が微動しても、マニピュレータの位置関係が変化しても、拘束条件設定に誤差が合っても、その状況に応じて拘束条件を変更することなくスレープ部3を所望な姿勢へ誘導することができる。

【0046】また、基準姿勢のB については、はじめに決められた非拘束領域内での動きの入力情報を記憶して蓄え、その動きに統計処理を施しある傾向を見出すことができる。この結果が当初の基準姿勢と異なる場合には、当初の基準姿勢を統計処理で見い出された方向へずらすことで、ずらした場合の基準姿勢を新たな基準姿勢とする。このように基準姿勢を変化させることで自動的に拘束条件誤差を吸収し、より高度に操作性を向上させることができる。

【0047】スレーブ部3の特定自由度の軸が制御的に 拘束されている間、その特定自由度に対応するマスタ部 2の自由度に係る姿勢を任意に動かしても、スレーブ部 3の動作は影響されない。このため、マスタ部2の対応 する自由度が意図せずに動いてもスレーブ部3が意図し ない動作をすることが起こらなくなる。なお、意図せず 動くということは、人間工学的にいえば、その軸が動く ことにより生じる姿勢が、手のとる姿勢として安定して いるからである。すなわち、スレーブ部3の軸を拘束し たとき、その拘束に合わせてマスタ部2も同時に拘束し 両者の姿勢を一致させようとすると、術者20は無理な 動きを強いられることとなり、操作性が悪化することに なる。 スレーブ部3を拘束中であってもマスタ部2を拘 束しない機能を備えることによって、 術者20の手技を 無理なく実現でき、より正確で安全な処置を可能にする 40 ことができる。

(1)を満たす非完全拘束領域下では両者の比を1: γ とする。この γ の値を1より小さくすることで、非完全 拘束領域下でのスレーブ部3の動きに制限をかけ、術者 20に対しても拘束感を出すことができる。さらにマス タ部2からの比較する入力信号にはフィルタ処理を施 し、手ぶれなどにより発生する高い周波数入力をカット する。また同時に、姿勢角度 θ B の変化分の大きさによって、その変化分がある値より大きいものは意味のある 動きと解釈しカットせずに非完全拘束条件下で動作させ はスレーブ部3の拘束される特定自由度に対応する自由 6.拘束条件下での操作であるから術者20はその操作 50 度の軸である。術者20は、操作部41を把持しなが

ら、操作部44を第1操作軸45の回りや第2操作軸4 2の回りに回転するように力を加え、スレーブ部3に操 作指令を送る。図3の(a)は無理な姿勢を示し、図3

の(b)は楽な姿勢を示す。

11

【0049】また、スレーブ部3による目的の動作が終 了すると、侑者20が拘束・解除司令部22へ拘束の解 除の指令を送ることにより、前述したように、制御演算 部21における演算結果に基づき、マスタ部2とスレー ブ部3との間の姿勢差が解消されるようにスレーブ部3 が駆動され、再びマスタ部2とスレーブ部3との間の姿 10 勢関係が一致している通常のマスタスレーブ方式で動作 することが可能になる。

【0050】次に、以下に上述の実施形態の種々の実施 例について説明する。

【0051】 [実施例1] ここでは、マスタスレーブ方 式で動作する一体型の医療用マニピュレータ1を操作 し、腹腔鏡下手術で難しいとされる縫合作業に、本発明 を適用した例を述べる。 縫合作業は、 図4に示すように グリッパ52に保持された糸53のついた彎曲針51を 術部50に円弧軌道を描くように刺入・刺出することで 20 達成される。この彎曲針51の刺入中において、刺入方 向以外に誤って誘導すると、必要以上に術部の細胞組織 を傷つけてしまうため、刺入方向はより正確であること が求められる。また、より正確に誘導することで彎曲針 51に余計な外力が加わりにくくなり、誤った誘導を軽

【0052】マスタスレーブ方式の医療用マニピュレー タ1を用いることで、任意の方向への縫合が可能とな る。このことは彎曲針51を円弧軌道に沿って誘導する のに一見適しているようではあるが、実際はそうではな 30 い。この原因のひとつは、スレーブ部3を円軌道に沿っ て誘導しても彎曲針51が操作者の意図した通りに誘導 できているとは限らないからである。なぜなら、刺入中 に針に外力が加わることで、スレーブ部3の姿勢に対し 彎曲針51の姿勢が変化してしまうからである。

【0053】このようなとき、刺入中の彎曲針51の変 動を認識し、その変化を修正しようとマニピュレータを 操作すればよいと考えられる。その方法のひとつに、彎 曲針51を持っている力覚を術者20に提示する方法が ある。しかしこの方法を実現するためには作業部である スレーブ部3に力覚センサを装着しなければならず、 医 療器具の洗浄・滅菌処理に対して適しているとは言えな い。また力覚センサを使用して微細な針の回転や位置ず れを検出するのは困難である。さらに付け加えるなら ば、彎曲針51の先端は細胞組織の中を通過しているの で、その際の位置を腹腔鏡の映像では確認することがで きず、視覚による修正も困難である。従って、縫合を行 う医療用マニピュレータ1に要求されることは、刺入中 に彎曲針51が変動しない強い把持力と、より簡易に彎 である。前述した通り、任意の方向へマスタ部2を正確 に円弧軌道で誘導することは、術者20が意図せず動か す動作軸が存在し困難である。

【0054】そこで、図5に示すように彎曲針51をヨ 一軸56に対し直角に把持し、先端のロール軸57を使 うことで円弧軌道誘導を直感的かつ容易にする。このと き、ヨー軸56を制御的に拘束することで彎曲針誘導に 関係のない軸が意図せず動作してしまうことを防ぐこと ができる。

【0055】なお、実際の作業で彎曲針51を直角に把 持することは困難である。直角に把持できていない状態 でヨー軸56を完全に拘束すると、ロール軸57だけの 動作となり、本来の目的である彎曲針51を正確に円弧 軌道で誘導することができない。 そこで彎曲針51を完 全には直角に把持できなくとも、その誤差を修正する動 作が必要である。それはヨー軸56の動作を非完全拘束 することによって可能になる。そこで、この非完全拘束 の範囲を式(1)に示されるように、決める姿勢角度α および8を定めることで、その範囲ではヨー軸56の動 作を許可し、彎曲針51を術部50に対して正確に誘導 するようにする。 手ぶれのような高い周波数の入力はカ ットされ、直角に把持できなかった姿勢を修正する比較 的ゆっくりとした動作のみを伝えることを可能にする。 【0056】ここで、仮に刺入中に通常のマスタ部2と スレーブ部3の間の姿勢関係が一致しているマスタスレ ーブ動作に戻りたい場合は、グリッパ52をいったん開 いて彎曲針51を放し、術部50から少し離れたところ でスレーブ部3の拘束を解除し、自動姿勢合わせ動作に より復帰する。刺入中にこのような事が発生するような 緊急時でもっとも危険なことは、彎曲針51を誤って動 作させ周辺の組織を傷つけることであるが、マニピュレ ータは彎曲針51を放すのでこの点において有効な方法 である。

【0057】刺入方向によっては、その開始姿勢がすで に手にとって無理な姿勢となることがある。このような とき、ヨー軸56を制御的に拘束した後、その状態のま ま、マスタ部2においてヨー軸56(図3における第1 操作軸45に相当する)を動作させ、それ以降の刺入動 作、ここではロール軸動作が行いやすい姿勢へ手を誘導 する。その後あらためてロール軸(図3における第2操 作軸42に相当する)を操作し縫合作業を完遂する。

【0058】 [実施例2] ここでは、医療用マニピュレ ータ1を操作し、胆管60から結石61を取り出す処置 について説明する。図6に示すように、この処置は胆管 60に沿って把持鉗子62で絞るようにして結石61を 送り出す。この際、胆管60に沿ってマニピュレータを 誘導し、胆管60に必要以上の外力を加え損傷させては ならない。従来の鉗子では自由度の不足により困難な作 業であった。医療用マニピュレータを使用することで胆 曲針51を円弧軌道上に誘導する機能を備えていること 50 管60に余分な力を与えず処置することを可能とした反

14

面、胆管60と垂直方向にさらに余分な外力を与えてし まう可能性を秘めることとなり安全性に問題が生じる。 【0059】そこで、胆管60の長手方向に垂直な方向 への動きに対しスレーブ部3の動作軸を制御的に拘束す る。胆管60に沿った拘束条件を設定する際に、胆管6 0の正確な位置情報が必要となってくるが、それを認識 し、拘束条件へ変換することは容易ではない。まして胆 管60などの内臓をある位置に固定しておくこと自体困 難であり、手術全体の効率を著しく低下させてしまう。 このような状況に適した拘束方法は、胆管60のある程 10 度の変動に対しても順応できる拘束であることであっ て、そのための手続きにおいて侑者20の負担を与えな いものである。そこである範囲を持ち高い外乱入力はカ ットする非完全拘束状態で操作するのである。

【0060】これにより、胆管60の微妙な曲がり具合 にも作業中の胆管60の動きにも、迅速に対応でき、か つ余計な損傷を与える動きが拘束されることで、胆管6 0を損傷せずより安全に結石61を取り出すことができ るようになる。

【0061】 [実施例3] ここでは図7を参照して、医 療用マニピュレータ1を操作し、血管等のや組織70を 切断する処置を行う場合の説明をする。切断面71を決 定した後、スレーブ部のグリッパ72 (はさみ) を操作 し対象の組織70を切断する。切断においては、周辺の 損傷を最小に抑えるために切断中に、その切断面71が ぶれることが無いように注意する。 医療用マニピュレー タを使用することで、任意の切断面71を実現できるよ うになった反面、グリッパ軸以外の姿勢軸が可動である ため、切断面71がぶれやすくなるという問題が生じ る.

【0062】そこで切断面71を決定した後、グリッパ 軸以外のスレーブ部3の制御軸を拘束することで、上記 で述べた問題を解消する。このときマスタ部2は拘束さ れないので、切断操作で手に余分な力がかかりマスタ部 2個の意図しない自由度を動作させても、スレーブ部3 に対し不必要な変動を与えることがない。

【0063】これは先端部に自由度を持ち、電気メスや 超音波メスの機能を備えた医療用マニピュレータに関し ても同様であり、切断面71に対しスレーブ部3の姿勢 を固定し作業を行うことで、組織70の損傷を最小にで 40 きるために有効である。

【0064】また、超音波メスのように自らが振動する 部分を持つような器具の場合、その振動が術者20の手 に伝わりさらに器具を振動させてしまうといった悪循環 が起きることがある。このような器具を大きく速く動作 させることは通常ないので、非完全拘束の領域を広めに 設定し、周波数カット能力の範囲を広げることで速い動 きと振動を抑制し、操作性のよい器具を提供することが

する上で、針や組織を把持したまま長時間手技を続ける のは、術者20にとって負担となる。そこで対象をつか んだ後、スレーブ部3のグリッパ軸のみ制御的に拘束す る、

【0066】把持動作において制御したいのは、その把 持力であることが多い。スレーブ部3の作業部の把持力 をマスタ部2のグリッパ (例えば、図3における操作部 41に相当)の軸の開閉角度と対応させ、開閉角度の大 きさにより把持力の大きさを指令するものである。組織 をつかむ作業においては、把持力が小さいと把持できず 大きすぎると組織を破壊してしまうので、適切な大きさ の力で把持しなければならない。そのためにはマスタ部 2のグリッパ角度を適切な値で保持しておかねばならな いが、この角度を維持しながら他の作業と併せて行うこ とは困難である。そこでマスタ部2のグリッパ角度とス レーブ部3の把持力との関係を調べておくか、グリッパ 角度の大きさを検出するセンサの出力をスレーブ部3の 把持力に変換するかすることで、スレーブ部3の把持力 を知り、その把持力の値に対して非完全拘束を行う。こ れは、入力情報はマスタ部2の角度であるのに対し、出 力情報がスレーブ部3が行う作業における力情報である 例である。このように、非完全拘束条件を力情報で表現 することにより、現実の実作業に適合した拘束条件を構 築することが可能になるとともに、非完全拘束であるた めに把持力の大きさの微調整も可能になる。把持対象の 部位によっては、その変形具合から把持力の大きさを拘 束した後、微調整が必要である場合があり、このような 場合の要求に対しては、完全拘束で対応することは困難 であり、上述のように非完全拘束によりある程度の範囲 30 に渡って部分的に拘束することが有用である。これによ り、掴むといった、手に力がかかる動作を持続させる必 要がなくなり、術者20の負担を軽減させることができ

【0067】[実施例5]従来の鉗子での操作に慣れた 術者20にとって、医療用マニピュレータ1を導入して も、すぐにその操作に精通するのもではない。そのよう な状態で手術を行うのは安全上問題がある。そこでスレ ーブ部3のグリッパ軸以外の自由度をすべて拘束し、医 療用マニピュレータ1を従来鉗子と同じ自由度にするこ とで、従来鉗子を操作している感覚でマニピュレータを 操作することを可能とする。

【0068】また、医療用マニピュレータ1の操作練習 において、熱棟度に合わせて自由度拘束の数を徐々に減 らすということが可能であり、効果的な訓練装置を提供 することができる。さらに、作業中またはその練習中 に、予め作業を決めておくことで、その作業を行う時点 で拘束すべき軸を内視鏡映像やマニピュレータ制御器に 呈示する。 例えば、 医療用マニピュレータ 1 を用いた縫 合練習の際、刺入位置に来た後、マニピュレータの拘束 【0065】[実施例4] 医療用マニピュレータを操作 50 手順が内視鏡映像に呈示される。そこにはヨー軸を固定 する手順が記載され、その手順を踏むごとに次の手順を示して縫合完了まで操作を導く。このように、その拘束の操作手順を教示することで、術者20は効率よく操作を習得することができ、また術中の誤動作を未然に防ぐことができる。

【0069】 [実施例6] 医療用マニピュレータ1の先端部が術中に腹腔鏡視野から外れることがある。現在の処置に対して、一時的に不要となったマニピュレータを体内に退避しておく必要があるときに頻繁に起こる現象である。このとき術者20は視野内の作業に集中し、視 10野から外れたマニピュレータに対しては注意力が低下する。

【0070】このようなときに発生する事故、すなわちマニピュレータを誤動作させ周辺の組織を損傷するといった事故を未然に防ぐために、スレーブ部3のグリッパ軸以外の自由度を拘束する。グリッパ軸は緊急時に対象を離すときに有効であるため拘束しない。こうすることで、術者20は視野内の作業に集中できる。

【0071】[実施例7] 医療用マニピュレータ1をトラカール5へ挿入するときやトラカール5から抜くとき 20に、スレーブ部3の先端部が任意の姿勢をとれるとすると、図8に示すように、領域75の部分がトラカール5を通過できない。このような状態でトラカール5を通過させようとすると、マニピュレータが損傷したり、トラカール5が抜けたりするといった事故を招く恐れがある。これはトラカール5内をスレーブ部3の先端部が通過中でも同様であり、スレーブ部3とトラカール5の内壁がこすれて、同様の事故が発生しうる。このような場合に対し、トラカール5から抜くと決定したならば、スレーブ部3の姿勢をトラカール5を通過可能な姿勢に操 30作し、自由度を拘束する。これにより安全にトラカール5を通過させることができる。

【0072】 [実施例8] 図9において、マスタスレー ブ方式で動作する一体型の医療用マニピュレータ本体と それを支持する支持装置80とを備えた医療用マニヒュ レータ1が示されている。この医療用マニピュレータ1 によれば、術者20はマニピュレータ本体の体感重量を 軽減でき操作性を向上させることができる。 図9に示す 支持装置80の各軸81,82,83にはアクチュエー タが取り付けられ任意の角度に制御できるように構成さ 40 れている。医療用マニピュレータ本体は、その一部で支 持装置80に支持され、さらに位置が決まっているトラ カール5を通過していることから、この支持装置80は 一体型マニピュレータのスレーブ部3の先端部の位置を 制御する働きを併せ持つ。マニピュレータが作業できる 領域には制限があり、その領域で操作すると体内に損傷 を与える恐れが著しく高い危険領域が存在することがあ る。そのような危険領域にスレーブ部3の先端部が入り 込まないように、支持装置80の自由度を選択的に拘束 することで、先端位置の自由度を拘束することができ

る。ただし拘束条件は患者の体に固定されたトラカール 5の位置をもとに算出されているため、拘束条件を非完 全拘束で設定し、患者の体が動くことが発生しても対応 できる状態を保ち手術の安全を図ることができる。

16

【0073】[実施例9] 前述の実施例1で説明した医療用マニピュレータを使用した縫合作業において、刺入方向を決定しヨー軸56を拘束した後に、さらにグリッパ52のグリッパ軸を制御的に拘束することで、術者20は残りのロール軸57の操作に集中することができる。これによって、より操作性を向上させることができる。これによって、より操作性を向上させることができる。このように複数の自由度の拘束を作業に応じて段階的に行うことにより安定した処置を実現することができる。また、複数の自由度を拘束する場合に、各々の自由度を作業のどの段階において拘束するかは術者20の意思によって決定することが可能であるため、その術者20の扱いやすい自由度の数を場面に応じて提供するようにしてもよい。なお、複数の自由度の拘束やその解除は、段階的ではなく同時的に行うことも可能である。

【0074】[実施例10]医療用マニピュレータが普及するにつれ、作業に応じた自由度数、術者20の好みに合った自由度数といった要求が出てくる。この要求に対し、共通のマニピュレータ本体を使用し、その機能を変化させることで対応する方法について説明する。

【0075】スレーブ部3の先端部に任意の姿勢を実現するためには、ロール、ピッチ、ヨーの3軸が必要である。これに把持する機能を有するグリッパ軸を付加すると、その自由度があらたに必要となる。これはマスタ部2に対しても同様である。しかし作業内容や術者20の扱い方などの違いから、必ずしも全ての自由度が必要とは限らず、かえって手技の阻害になる場合が考えられる。だからといって、その作業目的に応じて自由度の組み合わせ構成の異なる医療用マニピュレータを持ち替えて作業を行うのは手術の迅速性を損なう。さらに、種々の自由度の組み合わせ構成の医療用マニピュレータをそろえることは利用者側に経済的負担を課すことになる。そのため汎用でありかつ上記の要求が満たされる医療用マニピュレータが望まれる。

【0076】そこで、姿勢3自由度とグリッパ軸のような付加自由度をすでに持ち合わせたマニピュレータを基本型としたものに、あらかじめスイッチにより拘束自由度を任意に指定させる機能を備えるようにする。マニピュレータ本体には4つのスイッチが装着されており、それぞれのスイッチはロール、ピッチ、ヨーの3軸及びグリッパ軸の自由度に対応している。このスイッチがONの状態であると、それを認識した制御部1 bはその自由度を拘束する。スイッチのON/OFFの操作はその軸の種類、軸数に関わらず術者20が任意に行うことができる。このようにして、同じマニピュレータであるにも50関わらず、自由度数が異なり、マニピュレータとして違

う機能を備えたものを提供することができる。拘束自由度の指定は、スイッチの代わりに、制御部1bに直接入力したり、接点数が違うものを本体の所定の箇所にはめ込み、その接点数の違いで自由度の拘束指定を制御部1bに識別させることもできる。この接点カバーの色をその接点数に応じて変えることで、術者20は、色と機能との関連でそのマニピュレータの動きを判断するので、自分が操作しているマニピュレータの動きに対しての誤認識を減少させることができる。この自由度数の変更要求は、操作性が向上することで処置を安全に行うために10必要であるからで、それに応えたマニピュレータを提供

【0077】さらには、スレーブ部3の先端部を取り替えることのできる医療用マニピュレータにおいて、その自由度の配置を取り付け接点によって自動的に制御部1 bに認識させることで、マスタ部2側が共通であり、自由度数の違う種々のスレーブ部3の先端部を交換可能にすることができる。

することができる。

【0078】[実施例11]スレーブ部3側はロール 軸、ヨー軸、グリッパ軸の3軸を有し、マスタ部2側は 20 それに加えてピッチ軸の計4自由度を有している医療用 マニピュレータにおいて、その構成を実現するために、 実施例10で述べたように、ピッチ軸を見かけ上拘束 し、ピッチ軸に対応するマスタ部2からの指令を止め る。

【0079】このマニピュレータを操作しロール軸を9 0度回転させた姿勢で処置を続けようとすると、手の姿 勢がすでに90度ひねられた状態にあるので、操作性が 低下する。ここで、ある自由度を拘束することで作業が 成り立つならば、その自由度を拘束し、手の負担が軽い 30 姿勢にて作業を続ける方法は実施例1に示した。しか し、どの自由度も作業を続けるために必要である場合、 この方法は成立しない。

【0080】ここで、処置を困難にしているスレーブ部3の姿勢は、初期の状態に対しヨー軸とピッチ軸が入れ替わった姿勢と見なすことができる。そこで、一時的にグリッパ軸以外の自由度を拘束し、マスタ部2を操作し手に負担のない姿勢、つまり初期姿勢に戻した後、術者20の指令により、マスタ部2とスレーブ部3のヨー軸とピッチ軸の対応関係を入れ替える。その後に拘束を解40除することで、自由度数を減少させることなく、手の姿勢の負担が軽減された状態で処置を続行することが可能となる。

[0081]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の構成によれば、マスタ部の意図しない動きによってスレーブ部が意図しない動作をしてしまうことを防止でき、また、特定自由度の拘束解除後にマスタ部とスレーブ部との間に生じる姿勢差を補完することを簡易に行うことができるので術者は次の作業へスムーズに移行でき、作業の迅速性を向上させ、安全性の高い医療用マニピュレータを提供することができる。

18

【図面の簡単な説明】

) 【図1】本発明の一実施形態である一体型の医療用マニ ピュレータの機略構成を示す図。

【図2】マスタスレーブ方式で動作する医療用マニピュレータの構成を示すブロック図。

【図3】マスタ部の操作において手の姿勢によって作業 が困難性の有無を示し、(a)は無理な姿勢を示し、

(b) は楽な姿勢を示す。

【図4】 彎曲針を用いた縫合作業の流れを表した図。

【図5】 縫合作業時にスレーブ部が彎曲針を刺入方向に 対し直角に把持している様子を表した図。

1 【図6】胆管内の結石を、医療用マニピュレータを操作して取り出す作業を表した図。

【図7】医療用マニピュレータを操作して血管切断作業を行う様子を表した図。


【図8】医療用マニピュレータのスレーブ部の姿勢によってトラカールから抜くことが不可能であることを表した図

【図9】医療用マニピュレータ本体が支持装置に装着された医療用マニピュレータ1の構成を表した図。


【図10】非完全拘束状態における入力と出力の関係を 30 表した図。

【符号の説明】

- 1 医療用マニピュレータ
- 1a マニピュレータ本体部
- 1 b 制御部
- 2 マスタ部
- 3 スレーブ部
- 4 連結部
- 6 姿勢差検出手段
- 8 姿勢調整部
- 0 11 角度検出器
 - 12 角度検出器
 - 21 制御演算部
 - 22 拘束·解除司令部
 - 30 拘束状態表示部

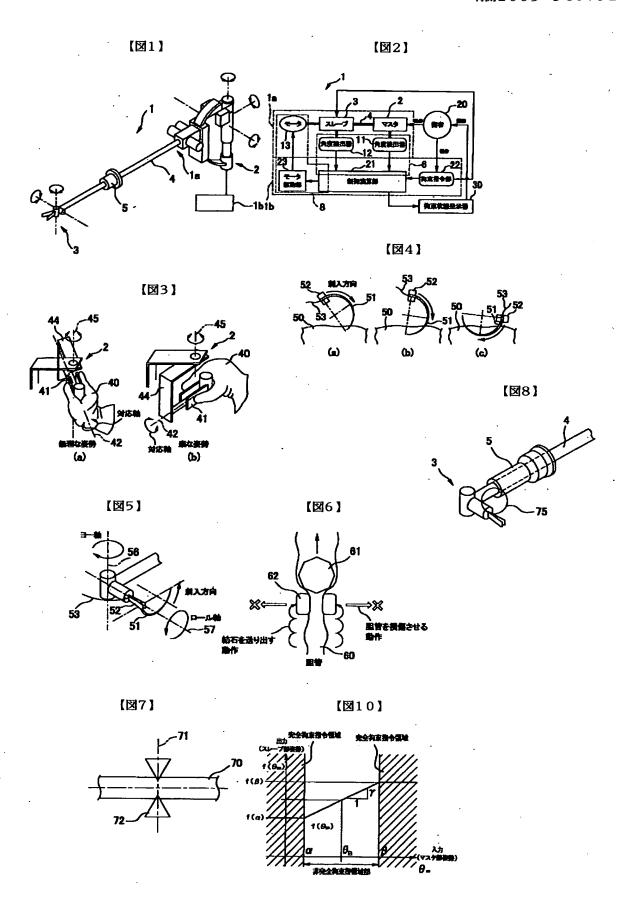

【図9】



フロントページの続き

(72)発明者 北 島 政 樹

東京都新宿区信濃町35番地 **慶應義塾**大学 医学部内

(72)発明者 森 川 康 英

東京都新宿区信濃町35番地 慶應義塾大学 医学部内 (72)発明者 小澤 壯 治

東京都新宿区信濃町35番地 慶應義塾大学 医学部内

(72)発明者 古川俊治

東京都新宿区信濃町35番地 慶應義塾大学 医学部内

(72) 発明者 中 澤 和 夫

神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1 慶

應義塾大学理工学部内

Fターム(参考) 30007 AS35 BS09 JT06 MT01 MT11